



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ  
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДА  
ГОСТ 2408.3—90

Издание официальное

Б3 3—90/178

15 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ  
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

**ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ****Методы определения кислорода**Solid fuel. Methods for determination  
of oxygen**ГОСТ****2408.3—90**

ОКСТУ 0309

**Срок действия с 01.01.91  
до 01.01.2001**

Настоящий стандарт распространяется на бурые и каменные угли, антрацит, горючие сланцы и торф и устанавливает расчетный и прямой методы определения массовой доли кислорода в интервале значений от 1 до 25 %.

При возникновении разногласий в оценке массовой доли кислорода анализ проводят прямым методом.

**1. РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД**

Метод основан на вычислении массовой доли кислорода по разности между суммой массовых долей компонентов, содержащихся в исследуемом топливе—зольности, общей влаги и серы, углерода, водорода, азота и кислорода, считая, что они составляют 100%, и суммой этих же компонентов без кислорода.

1.1. Массовую долю кислорода в аналитической пробе топлива ( $O_d^a$ ) в процентах вычисляют по формулам:

$$O_d^a = 100 - (W^a + A^a + S_t^a + C_t^a + H_t^a + N^a);$$

при массовой доле углекислоты карбонатов в аналитической пробе более 2,0%

$$O_d^a = 100 - (W^a + A^a + (CO_2)_M^a + S_t^a + C_t^a + H_t^a + N^a);$$

## С. 2 ГОСТ 2408.3—90

при определении кислорода с учетом поправок на минеральную массу

$$O_d^a = 100 - [A^a - 2,5 (S_A^a - S_{SO_4}^a) + 0,625 S_p^a + S_0^a + (CO_2)_M^a + W_M^a + W^a + C_t^a + H_t^a + N^a],$$

где  $W^a$  — массовая доля влаги в аналитической пробе, определенная по ГОСТ 11014 или ГОСТ 11305, %;

$A^a$  — зольность аналитической пробы топлива, определенная по ГОСТ 11022 или ГОСТ 11306, %;

$S_t^a$  — массовая доля общей серы в аналитической пробе топлива, определенная по ГОСТ 8606;

$C_t^a$  — массовая доля углерода в аналитической пробе топлива, определенная по ГОСТ 2408.1, %;

$H_t^a$  — массовая доля водорода в аналитической пробе топлива, определенная по ГОСТ 2408.1, %;

$N^a$  — массовая доля азота в аналитической пробе топлива, определенная по ГОСТ 2408.2, %;

$(CO_2)_M^a$  — массовая доля диоксида углерода из карбонатов в аналитической пробе топлива, определенная по ГОСТ 13455, %;

$S_A^a$  — массовая доля общей серы в золе аналитической пробы топлива, определенная по ГОСТ 8606, %;

$S_{SO_4}^a, S_p^a, S_0^a$  — массовая доля разновидностей серы в аналитической пробе топлива, определенная по ГОСТ 8606, %;

$W_M^a$  — массовая доля влаги в минеральной массе аналитической пробы топлива, %, вычисленная по формуле


$$W_M^a = Al_2O_3 \cdot 0,353 \frac{A^a}{100},$$

где  $Al_2O_3$  — массовая доля оксида алюминия в золе топлива, определенная по ГОСТ 10538, %.

1.2. Погрешность расчетного метода вычисляют исходя из погрешностей определений перечисленных компонентов в исследуемом топливе.

## 2. ПРЯМОЙ МЕТОД

Метод основан на количественном выделении кислорода топлива в виде  $CO_2$ ,  $CO$  и  $H_2O$  при термическом разложении навески топлива в токе аргона, восстановлении этих газообразных соединений над раскаленным углеродом (сажей) до  $CO$  и  $H_2$ , после-

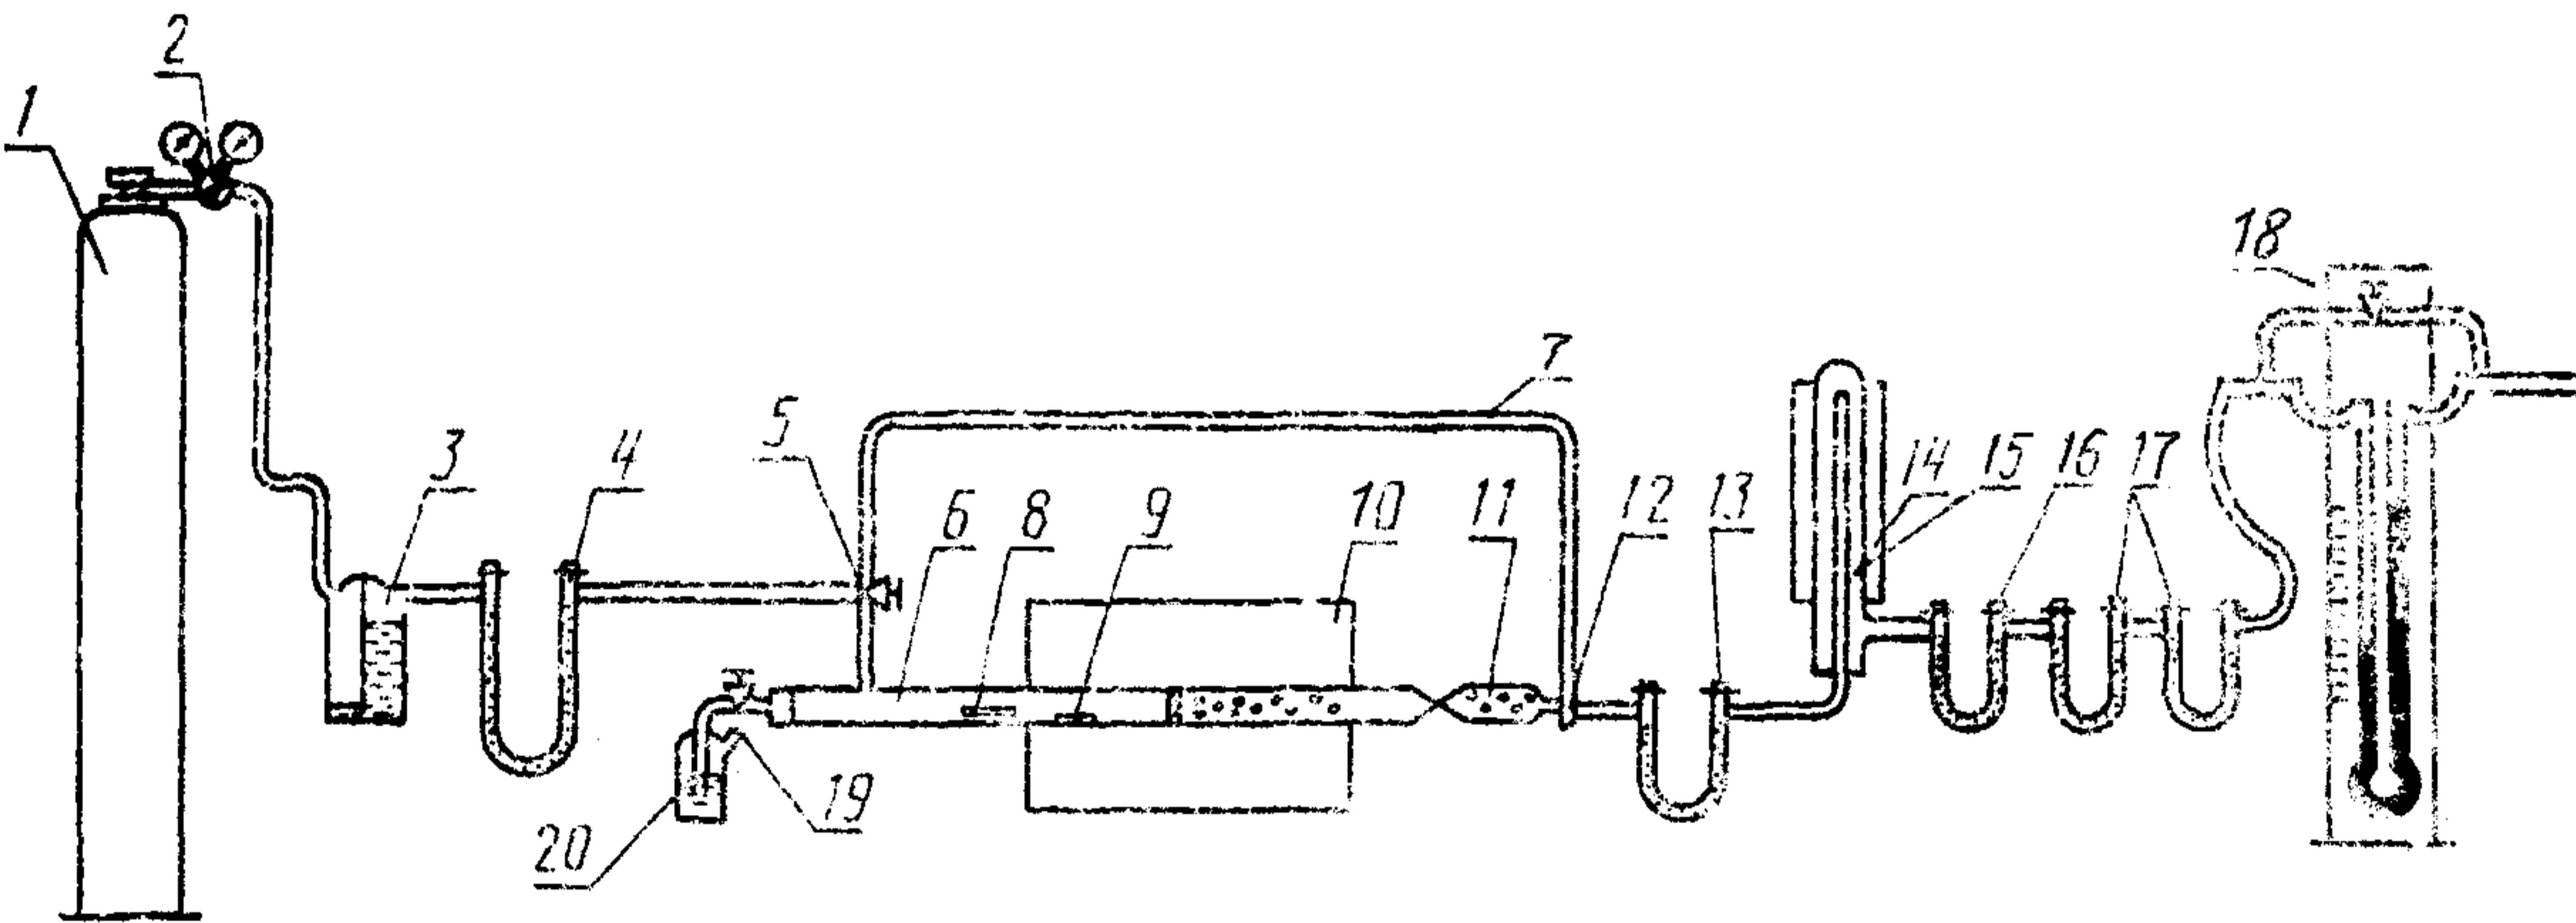

Черт. 1

## **С. 4 ГОСТ 2408.3—90**

дующем окислении оксида углерода до диоксида и гравиметрическом определении массы последнего.

Зольность исследуемого топлива должна быть не более 10%. При более высокой зольности топливо подвергают обогащению.

### **2.1. Метод отбора проб**

Отбор и подготовка проб для испытаний — по ГОСТ 10742 и ГОСТ 11303.

### **2.2. Аппаратура, материалы и реактивы**

Установка для определения кислорода, приведенная на черт. 1, состоит из баллона с аргоном 1 по ГОСТ 10157; редуктора с манометром 2; склянки для промывания газа 3 по ГОСТ 25336; U-образных трубок с аскаритом и ангидроном 4, 13 и 17; трехходовых стеклянных кранов 5 и 12 по ГОСТ 7995; реакционной кварцевой трубки; П-образной стеклянной трубки для обратного тока аргона 7 диаметром 5—6 мм (размеры по длине определяют при сборке установки); магнитного толкателя 8; изготовленного из кварцевой трубы, внутрь которой впаян железный стержень (см. черт. 4); кварцевой или фарфоровой лодочки № 1 по ГОСТ 9147 для сжигания навески 9; трубчатой горизонтальной электропечи 10 типа СУОЛ-0,25 1/12 М1; фильтра для улавливания летучих веществ 11, изготовленного из трубы термостойкого стекла диаметром 22—24 мм, длиной 80 мм, концы которой оттянуты до диаметра 5 мм, и заполненного ватой; трубчатой вертикальной электропечи 14 диаметром 22—24 мм и длиной 150 мм, обеспечивающей температуру нагрева  $(300 \pm 10)^\circ\text{C}$ ; трубы для окиси меди 15; U-образной трубы с ангидроном 16, изготовленной из термостойкого стекла; лабораторного реометра 18 любого типа, указывающего расход газа в интервале от 40 до 60 см<sup>3</sup>/мин, градуированного по истечению жидкости; прямого стеклянного крана 19 по ГОСТ 7995; склянки 20 типов СН-1, СН-2, СПТ и СПЖ вместимостью 25—50 см<sup>3</sup>.

Термопреобразователи типов ТПП и ТХА с гальванометрами.

Воронка фарфоровая для фильтрования под вакуумом по ГОСТ 9147.

Колба для фильтрования под вакуумом по ГОСТ 25336.

Насос стеклянный водоструйный лабораторный по ГОСТ 25336 или любой вакуумный.

Аппарат стеклянный для получения газа по ГОСТ 25336.

Пресс лабораторный для гранулирования сажи с отверстиями во вкладышах 2 мм.

Газометр стеклянный по ГОСТ 25336.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г. Допускается применять другие весы с аналогичными метрологическими характеристиками.

Трубки резиновые с внутренним диаметром 3—4 мм, длиной 20 мм.

Палочки стеклянные с оплавленными концами длиной 20—30 мм и диаметром 4—5 мм.

Крючок из жароупорной проволоки, с помощью которого извлекают лодочку из реакционной трубы.

Вата гигроскопическая по ГОСТ 5556.

Цинк металлический гранулированный по ТУ 6—09—5294.

Платина металлическая или платинохлористоводородная кислота.

Меди оксид гранулированный по ГОСТ 16539 или кусочки проволоки из чистой меди длиной 3—5 мм, диаметром 1—1,5 мм, окисленные при 800°C и отсеянные от мелочи и окалины.

Аскарит гранулированный с размером зерен 3—4 мм по ТУ 6—09—4128.

Магний хлорнокислый (ангидрон) безводный чистый с размером зерен не менее 3 мм по ТУ 6—09—3880.

Пемза.

Сажа по ГОСТ 7885.

Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277.

Фенолфталеин по ТУ 6—09—5360.

Кислота серная по ГОСТ 4204, ч.д.а.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, ч.д.а и раствор кислоты, разбавленной в соотношении 1:3.

Кислота азотная по ГОСТ 4461, ч.д.а.

Кислота уксусная по ГОСТ 61, ч.д.а.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

### 2.3. Подготовка к испытанию

#### 2.3.1. Подготовка реагентов

2.3.1.1. Сажу обрабатывают горячим раствором соляной кислоты, разбавленной в соотношении 1:3, на воронке с отсосом и промывают горячей водой до исчезновения реакции на ион хлора в промывных водах (реакция с азотнокислым серебром). Зольность полученной сажи не должна превышать 0,03%. Если зольность сажи превышает 0,03%, то обработку повторяют.

2.3.1.2. Далее сажу гранулируют при помощи лабораторного пресса, продавливая ее через отверстия вкладыша. Полученные нити режут на гранулы длиной 2—4 мм и сушат при температуре 105°C 2 ч. Высушенную сажу помещают в кварцевую трубку, через которую пропускают ток аргона в течение 30 мин, затем, не прекращая тока аргона, постепенно, в течение 2—3 ч, нагревают в печи до  $(1150 \pm 20)$ °C. При этой температуре продувку аргоном продолжают 8—10 ч. Печь выключают и продолжают продувку до охлаждения печи до 350—400°C. Полученные гранулы хранят в банке с притертой пробкой.

## **С. 6 ГОСТ 2408.3—90**

2.3.1.3. Для получения платинированной сажи 5 г платины растворяют в «царской водке» (три части соляной кислоты и одна азотной). несколько раз упаривают раствор (добавляя каждый раз 5—10 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты) до прекращения выделения окислов азота. Раствор упаривают досуха, смачивают 2 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты и гриливают горячую воду до растворения осадка.

К раствору добавляют 5 г очищенной сажи и воды для получения после перемешивания однородной пасты (если паста жидккая, ее упаривают). Пасту гранулируют при помощи пресса. Полученные нити режут на гранулы длиной 2—4 мм и сушат при температуре 150°C. Гранулы помещают в кварцевую трубку, через которую для вытеснения воздуха пропускают ток аргона. Трубку помещают в печь и постепенно нагревают до 800°C в течение 6 ч. Затем трубку охлаждают, продолжая пропускать аргон. После этого для восстановления хлорида платины в платинированной саже через трубку из аппарата для получения газа пропускают ток водорода до прекращения выделения хлористого водорода (проба по метил-оранжу), постепенно нагревают печь до 850°C и продолжают продувку 16 ч. Охлаждают трубку, продолжая пропускать водород. После охлаждения вытесняют водород аргоном. Для получения большого количества сажи соответственно должно быть увеличено количество реагентов.

Примечания:

1. Измельченную в процессе работы платинированную сажу собирают, смачивают водой до пастообразной массы и вновь готовят гранулы.

2. Вместо платины допускается использовать плагиногидролистоводородную кислоту с таким же соотношением платины и сажи.

2.3.1.4. Окись меди в проволоке обрабатывают горячим раствором уксусной кислоты, разбавленной в соотношении 1:9, промывают водой, сушат и 30 мин прокаливают в муфельной печи при температуре 800°C.

2.3.1.5. Посеребренную пемзу готовят следующим образом: 40 г азотнокислого серебра растворяют в 200 см<sup>3</sup> воды.

Готовят насыщенный раствор углекислого натрия и приливают его в раствор азотнокислого серебра до полного осаждения углекислого серебра. Осадок отфильтровывают на воронке с отсосом, на фильтре промывают водой и растворяют в водном аммиаке. Полученным раствором обрабатывают кусочки пемзы, затем пемзу просушивают и прокаливают при 300°C.


### **2.3.2. Подготовка аппаратуры**

2.3.2.1. Склянку для промывания газа (осушки аргона) заполняют концентрированной серной кислотой примерно на 1/3 объема.

2.3.2.2 U-образные трубки заполняют на 2/3 объема аскаритом и 1/3 объема ангидроном. Между аскаритом и ангидроном и перед соединительными отростками помещают слой гигроскопичес-

кой ваты, просушенной при температуре 105°C. Трубки закрывают резиновыми пробками. На соединительные отростки надевают резиновые трубы, один конец которых закрыт оплавленными палочками.

2.3.2.3. Реакционную кварцевую трубку (черт. 2) предварительно прокаливают при температуре 1000°C. Заполнение производят с конца, обращенного к очистительной системе, в следующем порядке: к оттянутому концу трубки помещают тампон из прокаленного асбеста длиной 2—3 мм, слой битого кварцевого стекла (размер кусков 2—3 мм) толщиной 40—50 мм, слой гранулированной сажи толщиной 130—150 мм (приготовленной, как указано в п. 2.3.1.2 или 2.3.1.3) и тампон из прокаленного асбеста длиной 5—10 мм. Входной конец трубки закрывают пробкой с прямым краном.

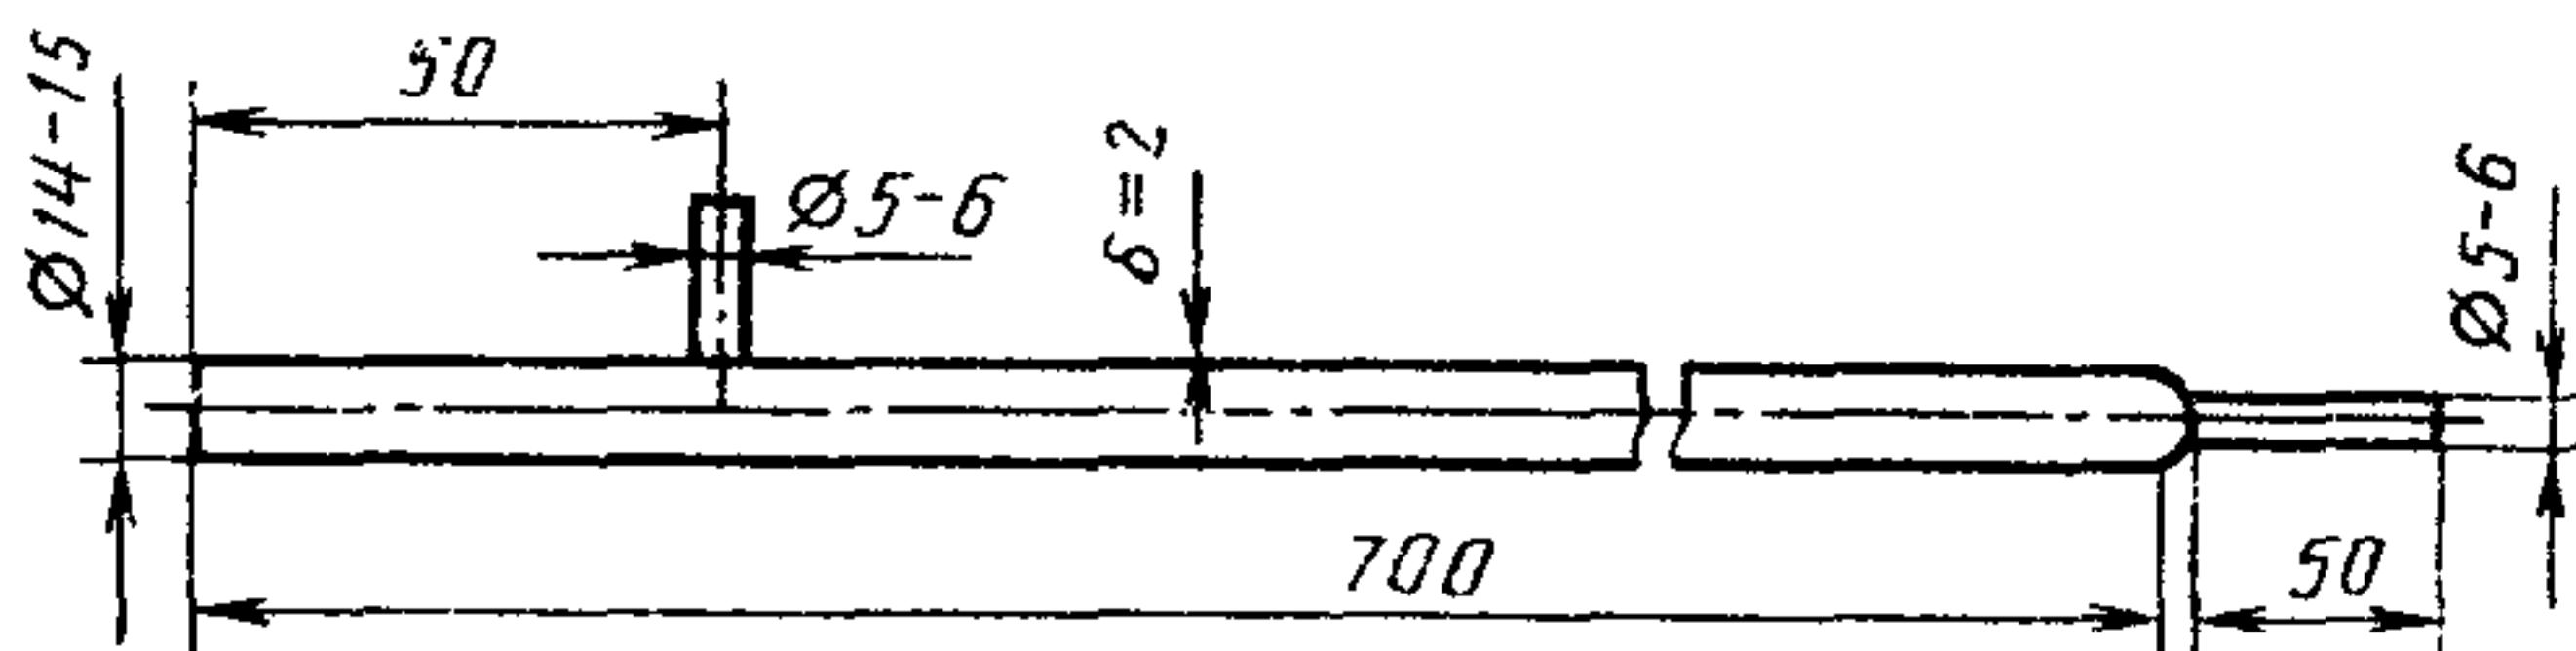

Черт. 2


2.3.2.4. Фильтр для улавливания летучих веществ заполняют гигроскопической ватой, предварительно просушенной при температуре 105°C.

2.3.2.5. У-образную стеклянную трубку по всей высоте заполняют посеребренной пемзой, приготовленной, как указано в п. 2.3.1.5. Перед соединительными отростками помещают слой просушенной ваты, трубку закрывают пробками, на соединительные отростки надевают резиновые трубы, один конец которых закрыт оплавленными палочками.

2.3.2.6. Трубку для окиси меди (черт. 3) заполняют окисью меди в проволоке, приготовленной, как указано в п. 2.3.1.4, до выходного отверстия внутренней трубы, после чего трубку заливают. У выходного конца помещают слой просушенной ваты.

2.3.2.7. У-образную трубку заполняют ангидроном, перед соединительными отростками помещают слой просушенной гигроскопической ваты, трубку закрывают пробками, на соединительные отростки надевают резиновые трубы, один конец которых закрыт оплавленными палочками.

2.3.2.8. В склянку типа СН-1, СН-2, СПТ или СПЖ вместимостью 25—50 см<sup>3</sup> наливают концентрированную серную кислоту таким образом, чтобы конец внутренней трубы был погружен в кислоту на 20—25 мм.

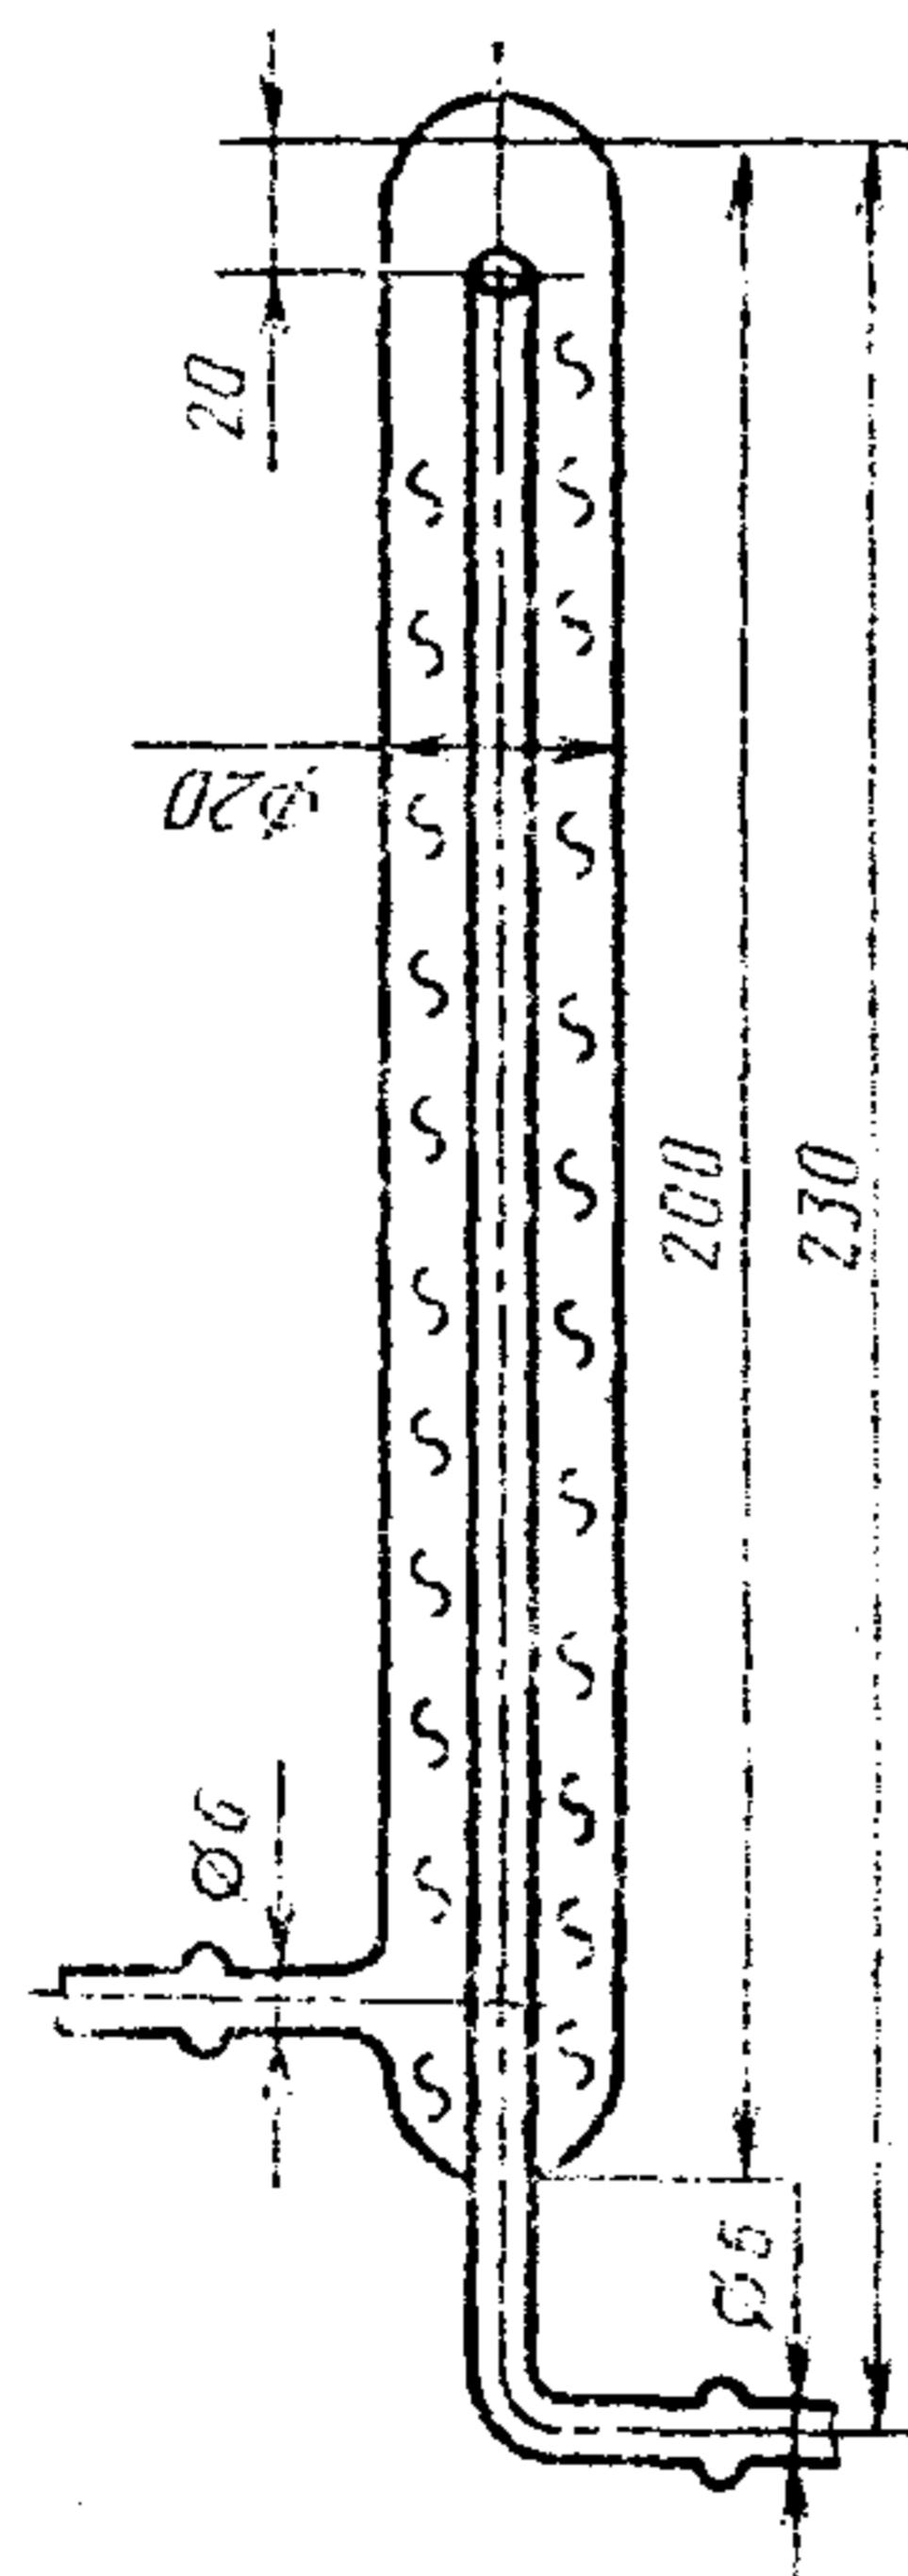

Черт. 3

### 2.3.3. Сборка установки и проверка ее на герметичность

2.3.3.1. Установку собирают по схеме, изображенной на черт. 1. Всю аппаратуру соединяют встык при помощи резиновых трубок длиной 20 мм, с внутренним диаметром 3—4 мм.

Последовательно соединяют баллон с аргоном, снабженный редуктором с манометрами, с очистительной системой — склянкой для промывания и сушки газа и U-образной трубкой с асак-

ритом. Затем реакционную кварцевую трубку помещают в трубчатую электропечь так, чтобы выходной конец ее (без учета оттянутой части) находился на расстоянии 50 мм от электропечи. Реакционную трубку через боковой отросток соединяют с очистительной системой при помощи трехходового крана. К выходному концу трубы присоединяют последовательно ватный фильтр для улавливания летучих веществ, трехходовой кран, U-образную трубку с аскаритом, трубку с окисью меди, U-образную трубку с ангидроном, U-образные трубы с аскаритом и реометр. К входному концу реакционной трубы, закрытой пробкой с прямым краном, присоединяют склянку типа СН-1, СН-2, СПН или СПЖ вместимостью 25—50 см<sup>3</sup>.

**Примечание.** При испытании топлив, содержащих более 4% серы, после фильтра для улавливания летучих веществ устанавливают U-образную трубку, наполненную посеребренной пемзой, как указано в п. 2.3.1.5.

К установке через трехходовые краны присоединяют П-образную трубку, с помощью которой осуществляют обратный ток аргона (продувку) через реакционную трубку.

2.3.3.2. После сборки установки ее проверяют на герметичность, для чего всю установку подсоединяют с помощью резиновой трубы с винтовым зажимом к газометру,циальному аргоном, и открывают винтовой зажим. Установка заполняется аргоном; если она герметична, то через 2 мин ток аргона должен прекратиться. Если ток аргона не прекращается, проверяют герметичность установки по частям.

2.3.3.3. После проверки установки на герметичность отсоединяют газометр и подсоединяют баллон с аргоном. Устанавливают скорость аргона 40—50 см<sup>3</sup>/мин по реометру. Продувают реакционную трубку в течение 1,5—2 ч без нагрева, затем включают горизонтальную трубчатую электропечь и в течение 2—3 ч поднимают температуру до  $(1000 \pm 20)^\circ\text{C}$  при применении в качестве восстановителя платинированной сажи и до  $(1150 \pm 20)^\circ\text{C}$  — гранулированной сажи. При этой температуре продолжают продувку еще 2—3 ч. Не прекращая тока аргона, выключают электропечь. Когда печь охладится до 350—400°С, ток аргона выключают в следующем порядке: отсоединяют реометр, свободный конец трубы с ангидроном закрывают резиновой трубкой со стеклянной палочкой, перекрывают трехходовые краны и закрывают бал-

## С. 10 ГОСТ 2408.3—90

лон с аргоном. Такой порядок отключения обеспечивает сохранение установки под давлением с аргоном.

2.3.3.4. Ежедневно через все стадии испытания, но без навески топлива проводят контрольный опыт для внесения поправки в результат испытания, при этом значение привеса трубок с аскаритом в контрольном опыте допускается не более 5 мг. Контрольный опыт повторяют до тех пор, пока разность привеса трубок с аскаритом при параллельных определениях будет не более 0,6 мг.

2.3.3.5. Вновь собранную установку (при смене реакционной трубы) проверяют определением массовой доли кислорода в чистом органическом веществе, для чего может быть использован фенолфталеин. Допускается применять другие органические вещества с известной массовой долей.

### 2.4. Проведение испытания

2.4.1. Перед началом определения открывают баллон с аргоном, поворачивая трехходовые краны так, чтобы был прямой ток аргона, снимают с U-образной трубы с ангидроном, резиновую трубку со вставленной в нее стеклянной палочкой, подсоединяют последовательно U-образные трубы с аскаритом и реометр. Затем устанавливают скорость тока аргона 40—50 см<sup>3</sup>/мин и продувают установку в течение 15—20 мин.

Включают электропечи и доводят в течение 30 мин температуру печи для пиролиза в зависимости от применяемой сажи до  $(1000 \pm 20)^\circ\text{C}$  или  $(1150 \pm 20)^\circ\text{C}$ , а печи для окисления — до  $(300 \pm 10)^\circ\text{C}$ . Температура электропечей на протяжении всего опыта автоматически поддерживается постоянной. Все это время продолжают продувку установки.

2.4.2. Снимают U-образные трубы с аскаритом, закрывают боковые отводы резиновыми трубками со вставленными в них стеклянными палочками и переносят их к весам для охлаждения и взвешивания. Затем поворачивают трехходовые краны в положение, при котором осуществляется с помощью П-образной трубы обратный ток аргона через фильтр для улавливания летучих веществ, реакционную трубку и склянку типа СН-1, СН-2, СНТ или СПЖ.


Обратный ток аргона продолжают 15 мин. За это время взвешивают U-образные трубы с аскаритом и набирают навеску.

2.4.3. Из аналитической пробы топлива, приготовленной по ГОСТ 10742 или ГОСТ 11303, берут в лодочку навеску массой 0,2—0,5 г в зависимости от массовой доли кислорода. Одновременно из той же пробы берут навески для определения массовой доли влаги испытуемого топлива по ГОСТ 11014 или ГОСТ 11305 и для определения углекислоты карбонатов по ГОСТ 13455.

2.4.4. Открывают входное отверстие реакционной кварцевой трубы, вносят в нее лодочку с навеской, вслед за ней магнитный

толкатель (черт. 4), закрывают отверстие резиновой пробкой с прямым краном и склянкой типа СН-1, СН-2, СНТ или СПЖ и при открытом кране продолжают продувку обратным током аргона в течение 2 мин.

#### Магнитный толкатель

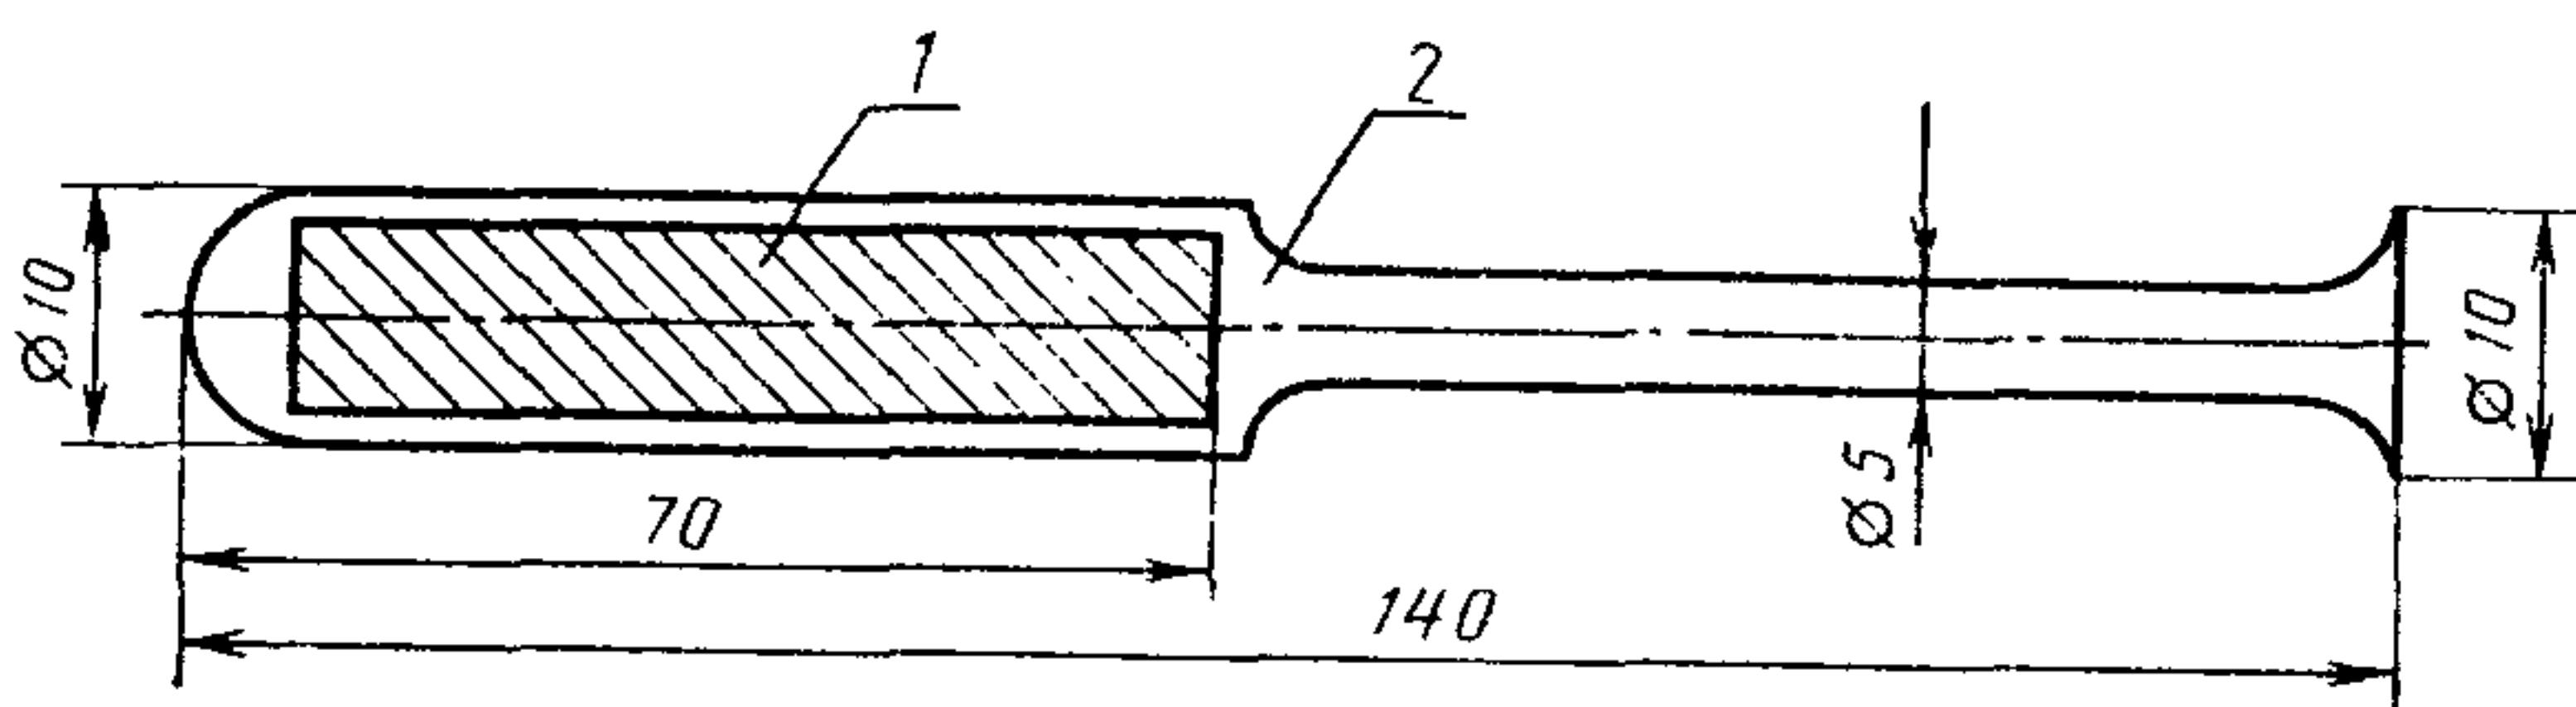

1—железный стержень; 2—кварцевая трубка

Черт. 4

2.4.5. Поворачивают трехходовые краны так, чтобы мог быть осуществлен прямой ток аргона, минуя П-образную трубку, непосредственно через реакционную трубку и далее через фильтр для улавливания летучих веществ, U-образную трубку с аскаритом, трубку с окисью меди, U-образную трубку с ангидроном и реометр. Продувку продолжают в течение 2 мин. Затем отсоединяют реометр, подсоединяют U-образные трубы с аскаритом для поглощения двуокиси углерода и вновь присоединяют реометр.

2.4.6. Постепенно, при помощи магнитного толкателя и магнита, вводят лодочку с павеской в раскаленную часть реакционной кварцевой трубы следующим образом: вначале лодочку выдерживают 2—5 мин у входа в печь, затем примерно в течение 10 мин продвигают в раскаленную часть, после чего продолжают продувку аргоном 15 мин.

2.4.7. По окончании продувки отсоединяют реометр и поглотительные U-образные трубы с аскаритом, закрывают их боковые отводы резиновыми трубками со вставленными в них стеклянными палочками и переносят к весам для охлаждения и взвешивания.

2.4.8. Поворачивают трехходовые краны для создания обратного тока аргона. Открывают входное отверстие реакционной кварцевой трубы, магнитом из нее извлекают магнитный толкатель, а крючком из жароупорной проволоки — лодочку. Закрывают пробкой входное отверстие при открытом прямом кране, продолжая обратный ток аргона.

2.4.9. При каждом новом испытании поступают, как указано в пп. 2.4.4—2.4.8.

2.4.10. После испытания электропечи выключают, поворачивают трехходовые краны для прямого тока аргона и продувают систему до тех пор, пока температура электропечи для пиролиза снизится до 350—400°C. После этого отключают реометр, свободный отвод U-образной трубки с ангидроном, закрывают резиновой трубкой со вставленной в нее стеклянной палочкой, затем последовательно перекрывают трехходовые краны 12 и 5 и однодревней 19 (см. черт. 1), прекращают подачу аргона и закрывают баллон.

2.4.11. Определение массовой доли кислорода производят параллельно в двух навесках.

## 2.5. Обработка результатов

2.5.1. Массовую долю кислорода в аналитической пробе испытуемого топлива ( $O^a$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$O^a = 36,36 \frac{(m_2 - m_1) - (m_4 - m_3)}{m} - (a + b),$$

где  $m_2$  — масса U-образных трубок после проведения испытания, г;

$m_1$  — масса U-образных трубок до проведения испытания, г;

$m_4$  — масса U-образных трубок после проведения контрольного опыта, г;

$m_3$  — масса U-образных трубок до проведения контрольного опыта, г;

$m$  — масса навески испытуемого топлива, г;

$a$  — массовая доля кислорода в составе влаги испытуемого топлива, равная  $\frac{8}{9}$  массовой доли влаги в аналитической пробе, %;

$b$  — массовая доля кислорода в составе углекислоты карбонатов испытуемого топлива, равная  $\frac{8}{11}$  массовой доли углекислоты карбонатов в аналитической пробе, %;

36,36 — коэффициент для пересчета двуокиси углерода на кислород;

2.5.2. Допускаемые расхождения между результатами двух параллельных определений при доверительной вероятности  $P = 0,95$  не должны превышать значений, указанных в таблице.

Массовая доля кислорода, %	Допускаемые расхождения, % (абс.)
От 1 до 2 включ.	0,1
Св. 2 » 5 »	0,2
» 5 » 12 »	0,3
» 12 » 25 »	0,4

2.5.3. За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, если расхождения не превышают допускаемых.

Если расхождения между результатами двух определений превышают значения, указанные в табл. 3, то проводят третье определение и за конечный результат принимают среднее арифметическое двух наиболее близких результатов в пределах допускаемых расхождений.

2.5.4. Вычисление результатов анализа, а также пересчет результатов на другие состояния производят до второго десятичного знака и округляют до первого.

2.5.5. Пересчет результатов анализа на другие состояния топлива — по ГОСТ 27313.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством metallurgii СССР  
РАЗРАБОТЧИКИ  
Л. А. Коган, канд. техн. наук (руководитель темы); П. Н. Горелов; Р. И. Гориславцева; З. И. Носкова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.03.90 № 462
3. Срок первой проверки — 1996 г.
4. Стандарт полностью соответствует стандарту ИСО 1994—76
5. ВЗАМЕН ГОСТ 2408.3—75
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГССТ 61—75	2.2
ГОСТ 1277—75	2.2
ГОСТ 2408.1—88	1.1
ГОСТ 2408.2—75	1.1
ГОСТ 3118—77	2.2
ГОСТ 4204—77	2.2
ГОСТ 4461—77	2.2
ГОСТ 5556—81	2.2
ГОСТ 6709—72	2.2
ГОСТ 7885—86	2.1
ГОСТ 7995—80	2.2
ГОСТ 8606—72	1.1
ГССТ 9147—80	2.2
ГОСТ 10157—79	2.2
ГОСТ 10538—87	1.1
ГОСТ 10742—71	2.1; 2.4.3
ГОСТ 11014—81	1.1; 2.4.3
ГОСТ 11022—75	1.1
ГОСТ 11303—75	2.1; 2.4.3
ГОСТ 11305—83	1.1; 2.4.3
ГОСТ 11306—83	1.1
ГОСТ 13455—76	1.1; 2.4.3
ГОСТ 16539—79	2.2
ГОСТ 24104—88	2.2
ГОСТ 25336—82	2.2
ГОСТ 27313—87	2.5.5
ТУ 6—09—3880—75	2.2
ТУ 6—09—4128—75	2.2
ТУ 6—09—5294—86	2.2
ТУ 6—09—5360—87	2.2

Редактор *М. Е. Искандарян*  
Технический редактор *М. И. Максимова*  
Корректор *В. С. Черная*

Сдано в наб. 19.04.90 Подп. в печ. 27.06.90 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,84 уч.-изд. л.  
Тир. 6000 Цена 15 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1832